


# Espectrofotômetro da série CM (Amostra)

KONICA MINOLTA, INC.  
 Unidade de Negócios Sensing  
 Divisão de Garantia de Qualidade

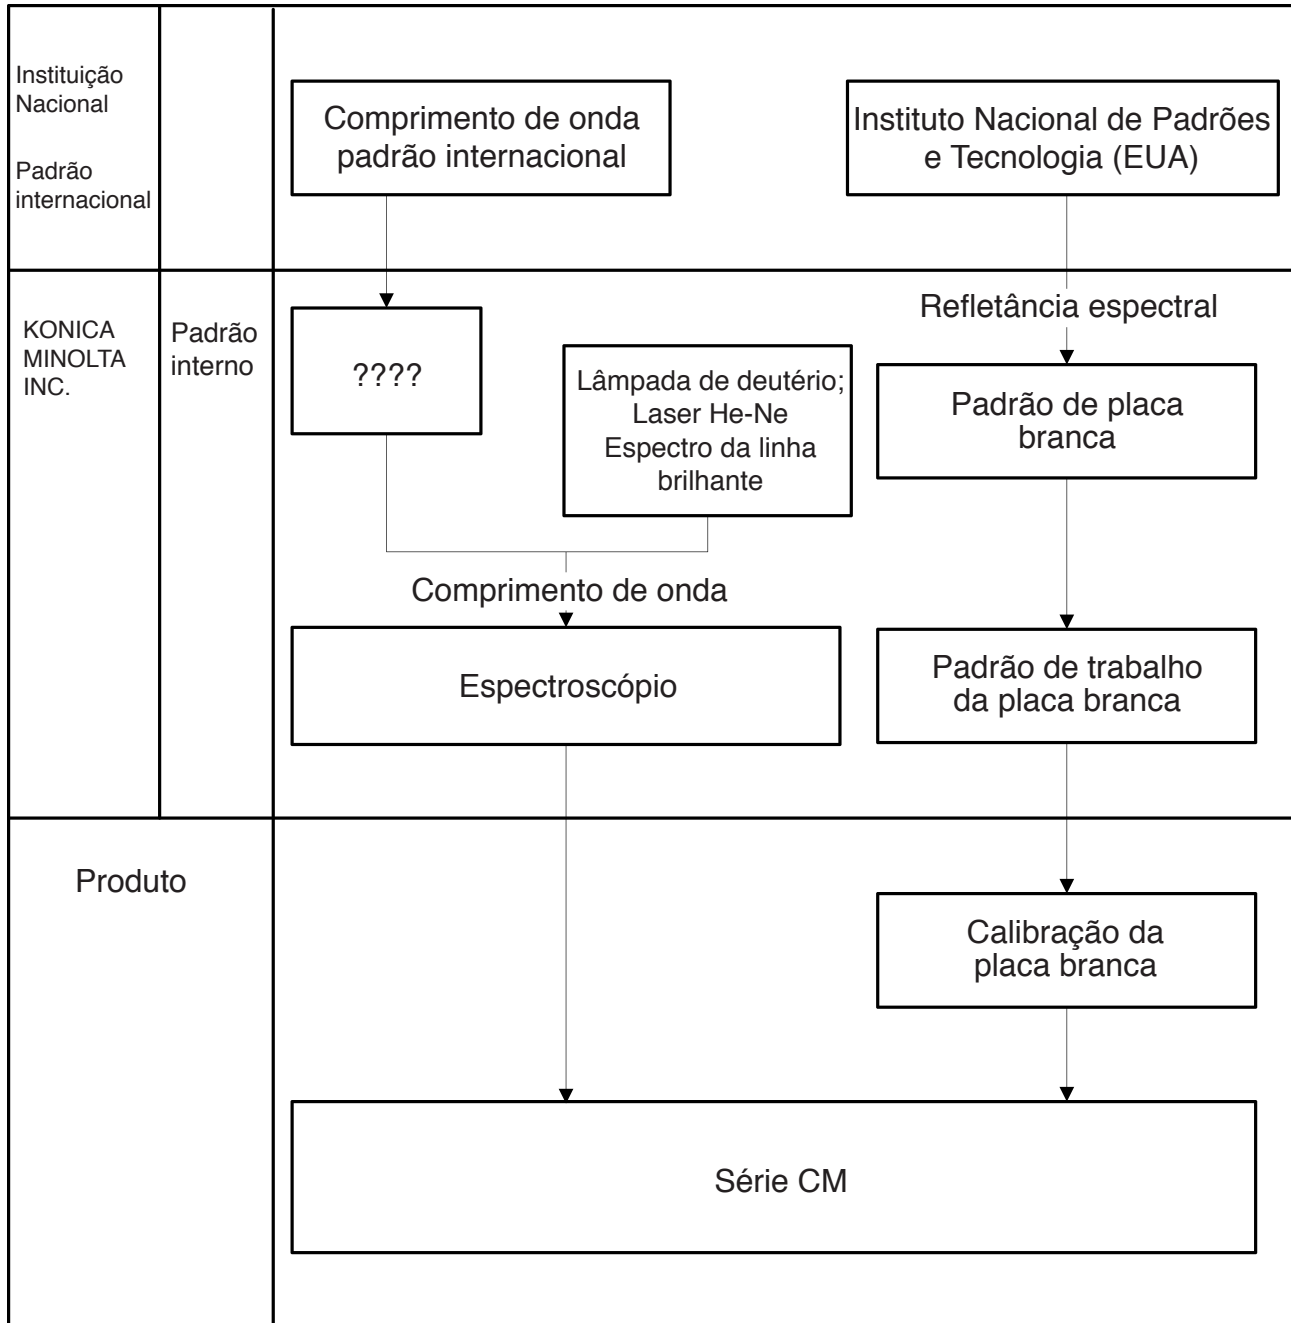

Intervalo entre calibração:

Espectroscópio: 1 ano

Padrão de Placa Branca: 5 anos

Trabalho Padrão de Placa Branca: 1 ano